SDI una división de Bio-Medical Research

• Compañía privada irlandesa, 236 empleados

• Expertos en músuclos por 40 años, utilizando tecnología médica para promover la recuperación muscular para uso del consumidor.

• Nuestro producto usa tecnología EMS que se especializa en acondicionamiento, firmeza y levantamiento de los músculos.

• Todos los productos han sido aprobados por la FDA y probados clínicamente.

Orgullosos de ofrecer por primera vez en el mercado mexicano
nuestro Cinturón Abdominal de Acondicionamiento
3 millones de unidades vendidas mundialmente

Cómo trabaja Slendertone?

Etapa 1. Señales / pulsaciones enviadas entre las almohadillas.

Etapa 2. Estas señales llegan a los nervios.

Etapa 3. Los nervios se contraen y relajan los músculos.

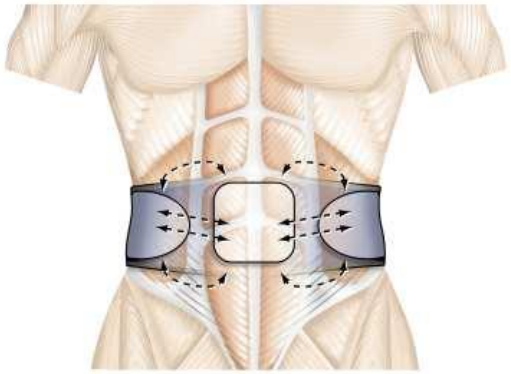

Etapa 1

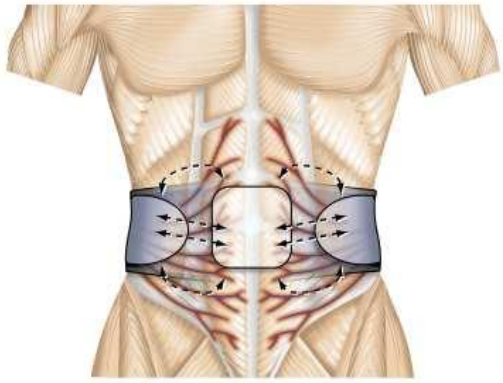

Etapa 2

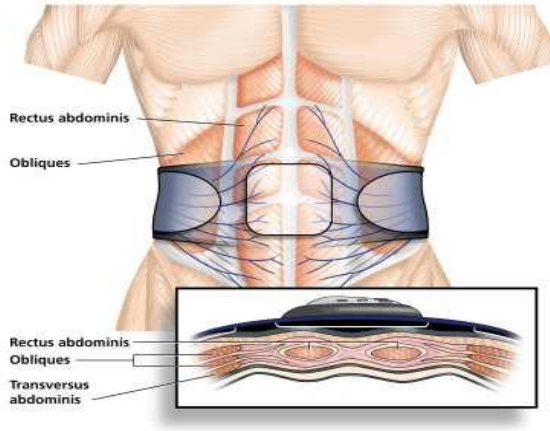

Etapa 3

Porqué es efectivo Slendertone?

1. Rango de Intensidad- Trabajo muscular efectivo

2. Almohadilla- Contracciones musculares confortables

3. Ubicación de las almohadillas- Trabajo muscular efectivo y confortable

GelPads (almohadillas de gel)

Grande/Patentado/Grado Médico/Formado para el cuerpo

GRID – Las pulsaciones se distribuyen sobre la almohadilla
(No hay puntos calientes)
Esto permiteun trabajo muscular confortable..
Sin residuos pegajosos, reutilizable hasta 20-30veces (dependiendo del tipo de piel)

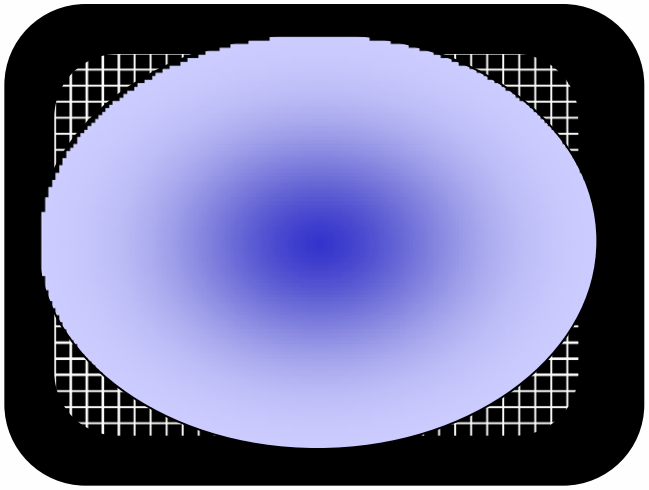

Las almohadillas Slendertone son superiores a cualquier otra almohadilla. (Las contracciones musculares son fuertes pero no generan escozor.)

Remueva las cubiertas plásticas del lado plano de los GelPads™ y envuelva el cinturón alrededor de su cintura asegurándose que los GelPads™ se adhieran firmemente al cinturón y a su piel.

MANTENGA las cubiertas plásticas para recolocarlas después de cada sesión.
Esto asegura que las almohadillas duren más tiempo.

SLENDERTONE

UBICACION DE LAS ALMOHADILLAS

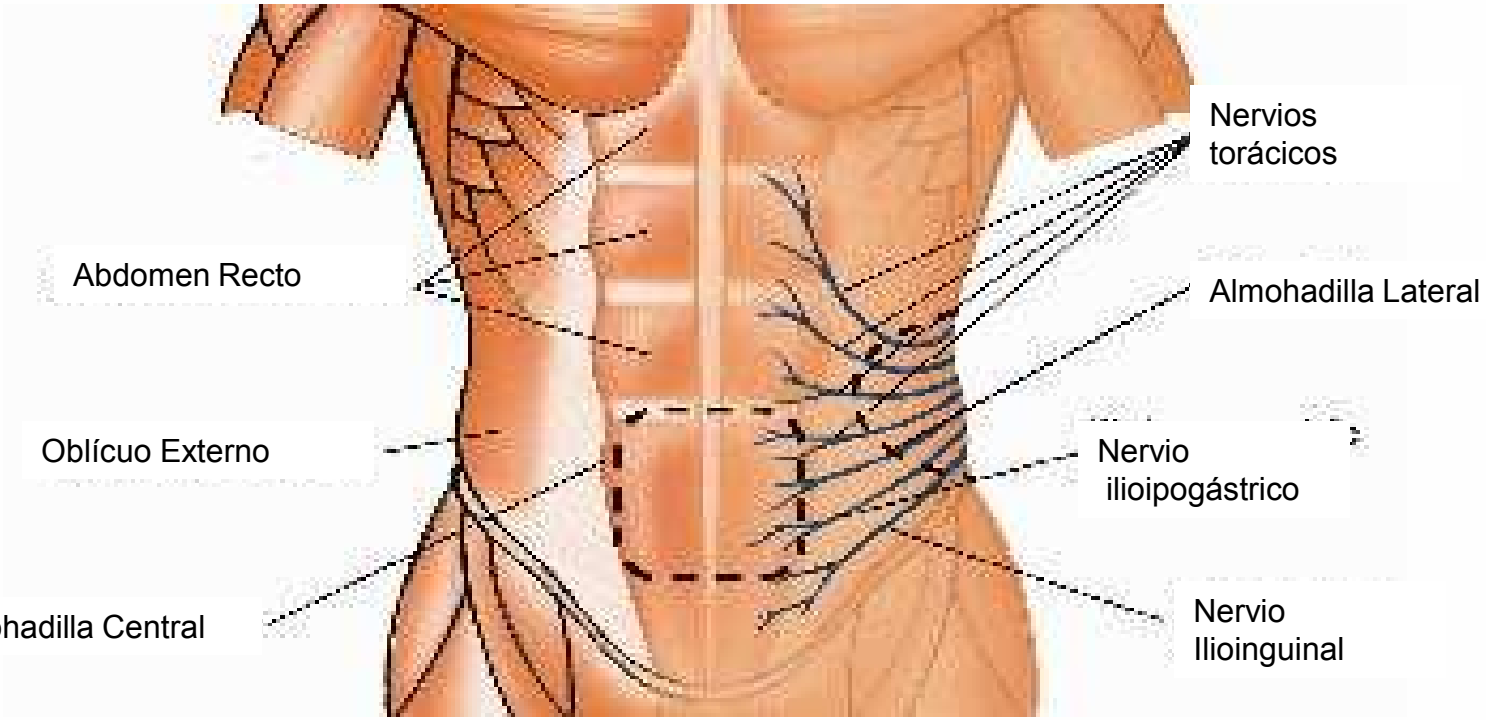

Primero, las señales son enviadas entre 3 GelPads de grado médico… Alcanzando los nervios que se ramifican a partir de los tres músculos abdominales principales… causando contracciones de elongamiento profundas que tonifican y estiran los músculos abdominales

Otros diferenciadores claves

Probado clínicamente

Es el único producto que ha sido verificado por medio de pruebas independientes realizadas por científicos altamente calificados.

Mayor seguridad

Su seguridad está certificada según los estándares aplicables a Dispositivos Médicos y la autorización liberada por la FDA como "seguro y efectivo."

Conveniente

No es necesario utilizar un gel que ensucie. La mayoría de los productos de la competencia requieren gel que debe ser esparcido sobre el área del estómago.

BMR
BIO-MEDICAL RESEARCH LTD

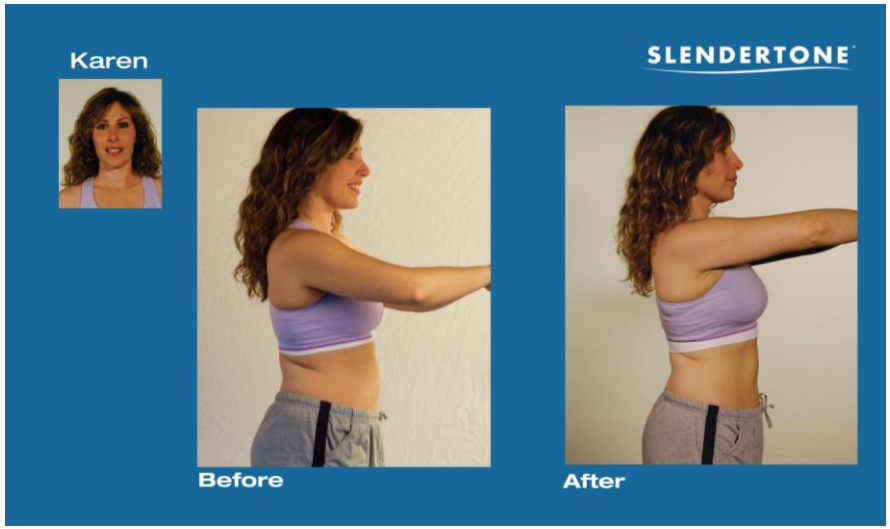

ANTES Y DESPUES

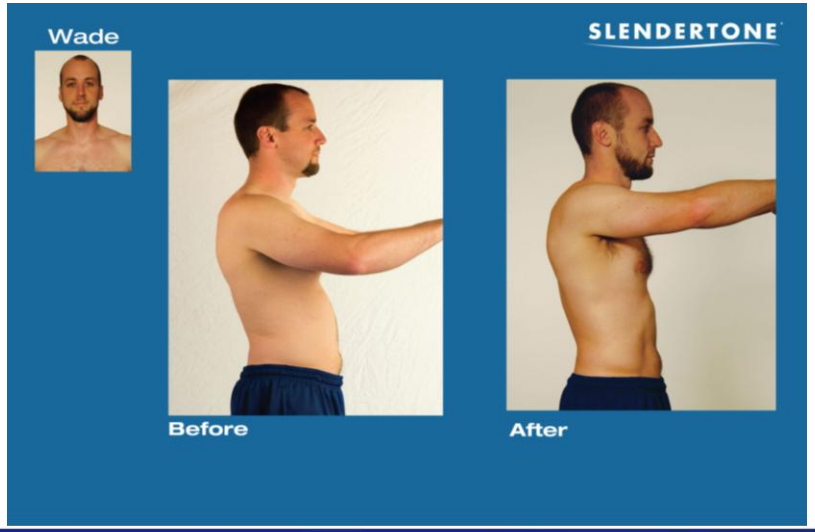

Comparacion Slendertone vs. Competidor

Slendertone Flex Pro Tonificador Abdominal	Abtronix 2
• Utiliza tecnología EMS clínicamente demostrada	• Usa una técnica científicamente probada que genera “contracciones activas a los músculos” (EMS)
• Diseñado para hombres y mujeres	• Diseñado para hombres y mujeres
• Resultados serán visibles en 6 semanas (varían desde 4 hasta 8)	• No indica cantidad de tiempo en que se verán resultados.
• Utiliza 5 veces a la semana por 4 semanas para ver músculos abdominales mas firmes y definidos. Selecciona entre programas de 20, 25, 30 o 40 minutos.	• 10 minutes al día
	• Gel debe ser colocado por el usuario antes de usar el cinturón.
• Pulsaciones alcanzan nervios que llegan hasta los 3 músculos abdominales principales.	Cinturón debe ser colocado encima del área a ser tonificada. Ej. abdominales superiores , vs. Abdominales inferiores.
• Ejercita efectivamente todos los músculos abdominales.	• También tonifica – trasero, pecho, cuello, hombros & pectorales
• 7 programas con intensidades que varían desde 0 hasta 99.	• 8 programas con 10 niveles de intensidad.
• Cinturón alcanza desde 24” – 47”	

BMR
BIO-MEDICAL RESEARCH LTD

Slendertone Flex Pro

- 7 programas
- Niveles de Intensidad 1 a 99
- Unidad de control operada con baterías
- Para tamaños de cintura de 24” a 47”

El empaque contiene:

1. Unidad de Control
2. 1 Juego de 3 Electrodos
3. 1 paquete de 3 Baterías AAA
4. 1 Cinturón Gris
5. Bolsa de viaje
6. Manual de Instrucciones
7. Guía de Inicio Rápido

Tonificador Abdominal: Instalación

• Inserte las baterías en el controlador

• Gire el cinturón para que las marcas blancas estén del lado de arriba.

• Las marcas indican el posicionamiento de los GelPads –

mayor separación= mayor tamaño

• Remueva las cubiertas plásticas que están sobre las flechas naranjas, de lado de sujeción del GelPad cuadrado.

• Coloque dentro de las marcas cuadradas blancas del cinturón. Asegúrese que el GelPad cubra el contacto de metal. Presione firmemente el GelPad con la palma de su mano.

• A continuación remueva las cubiertas plásticas que están sobre las flechas naranjas de los GelPads de forma oval. Posiciónelos a la derecha e izquierda del cinturón – seleccione las marcas que indican el tamaño apropiado. Asegúrese que los GelPads cubran los contactos de metal.

Tonificador Abdominal: Instalación

• Gire el cinturón y adjunte el control al contacto que está al frente del cinturón. Empuje el contacto hasta el fondo del control y asegúrese de que se inserte completamente.

• Voltee el cinturón y remueva las cubiertas plásticas del lado plano de los GelPads.

• Envuelva el cinturón firmemente alrededor de su cintura bajo sus ropas – de forma a que los GelPads se adhieran a su piel.

• Presione el botón ON/Off por 2 segundos hasta que se encienda el display.

• Use las flechas que apuntan hacia su pecho para aumentar el nivel de intensidad hasta que usted sienta una contracción muscular fuerte pero confortable. Las flechas derecha e izquierda controlan cada lado separadamente. La unidad no iniciará hasta que el nivel de intensidad se aumente.

• Intente aumentar el nivel de intensidad cada 5 minutos durante su sesión.

Tonificador Abdominal: Control

Botón de encendido (power)

Botón de Programación

Botón de Información

Aumentar Intensidad

Disiminuir Intensidad

Tonificador Abdominal: Display

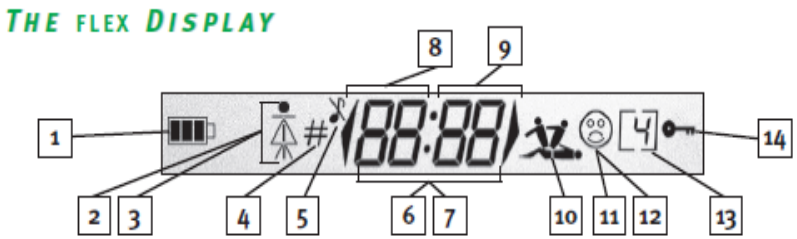

SLENDERTONE FLEX tiene una pantalla de display única que permite ver el nivel de batería, el tiempo restante, las fases de contracción/relajación, el programa actual, los niveles de intensidad y otras informaciones. Esta es una breve descripción de cada símbolo de la pantalla de display.

1 Este símbolo indica el nivel de batería

2 Muestra el nivel de intensidad alcanzado a la fecha

3 Esto le indica que hay un problema con las almohadillas (ver la Guía de Solución de Problemas en la página 15 para mayores detalles)

4 Indica el número de sesiones completadas

5 Indica que el sonido está apagado (modo de MUTE)

6 10:08 Muestra el tiempo de duración de la sesión actual en minutos y segundos. Se usa también para indicar mensajes de error (ver pág. 12). El timer usa un conteo en reversa del tiempo que queda de cada sesión.

7 Aparece cuando el ejercicio está en pausa (se debe presionar el botón On/Off brevemente para reiniciar el ejercicio)

8 150 Intensidad del lado izquierdo del cinturón

9 461 Intensidad del lado derecho del cinturón

10 Se endereza para indicar que los músculos están trabajando, y se acuesta cuando los músculos están relajados

11 Aparece cuando hay progresos, por ej. Cuando la unidad está encendida, cuando llega a un nuevo nivel de intensidad, cuando está listo para avanzar a un programa superior y cuando ha completado una sesión.

12 Aparece cuando apaga la unidad antes que la sesión se complete.

13 Indica el programa que está utilizando (1,2,3 o 4)

14 Bloqueo de teclado activo – usted no puede cambiar la intensidad o el nivel de programa accidentalmente.

GelPads™ de reemplazo
Tonificador Muscular Abdominal

PARA USO CON

TODOS LOS TONIFICADORES ABDOMINALES SLENDERTONE

Todas las almohadillas de reemplazo Slendertone y sus accesorios están fabricadas con grado médico.

El tiempo de vida útil de las almohadillas depende de un número de factores incluyendo el tipo de piel, la frecuencia de uso, cómo se almacenan las almohadillas, etc.

Se recomienda el reemplazo de las almohadillas después de 20-30 sesiones.

Guarde las cubiertas plásticas de la superficie de los GelPads. Después de cada uso, coloque las cubiertas plásticas nuevamente en la superficie de las almohadillas para protegerlas del polvo y mantener su humedad.

Preguntas frecuentes

Qué son los productos Slendertone y cómo funcionan?

Slendertone ofrece una variedad de artículos para tonificar que ejercitan sus músculos enviando pulsaciones eléctricas a partir del producto Slendertone a través de GelPads con grado médico a los nervios que controlan sus músculos, causando la contracción y relajación muscular.

Los productos Slendertone realmente funcionan? Y por qué debería elegirlos por encima del ejercicio tradicional?

SI ! Los productos tonificadores Slendertone consolidarán y tonificarán sus músculos. Esto ha sido demostrado clínicamente en varias evaluaciones y todos los productos Slendertone están autorizados por la FDA como seguros y efectivos para la tonificación y consolidación de los músculos.

Los ejercicios tradicionales, cuando no se realizan correctamente pueden ser poco confortables y posiblemente causar lesiones – Slendertone elimina la tensión del ejercicio y simplemente trabaja por usted! Y lo mejor es que usted puede hacer cualquier cosa, desde cardio hasta tareas del hogar mientras se ejercita!

Preguntas frecuentes

Yo tengo una enfermedad pre-existente, puedo usar el dispositivo Slendertone EMS De tonificación o acondicionamiento muscular?

Si el cliente tiene una de las siguientes enfermedades, no debe usar un producto Slendertone:

- Problemas cardiacos, incluyendo portadores de marcapasos.
- Diabetes del tipo que requiere inyectar insulina.
- Cáncer, particularmente si tiene lesiones cancerosas en la piel.

Si el cliente tiene algún otro problema de salud que no se menciona aquí, le recomendamos consultar con su médico antes de usar un producto Slendertone EMS.

Recientemente tuve un bebé, puedo usar un producto Slendertone EMS?

Usted debe esperar mínimo 6 semanas después del parto, y 3 meses después de una cesárea antes de usar un producto Slendertone EMS, esto para permitir que el tejido de la cicatrización sane completamente antes de ejercitar los músculos.
Le recomendamos consultar con su médico si tiene alguna duda al respecto.

Preguntas frecuentes

Puedo usar más de un producto Slendertone al mismo tiempo?

Slendertone recomienda que ejercite solo una parte del cuerpo a la vez – algunos de los productos se ubicarían unos sobre otros en el cuerpo, por lo que no le resultaría confortable estimular múltiples grupos musculares en forma simultánea.

Cuánto duran las almohadillas GelPads?

Esto varía en cada caso en particular en promedio duran de 20 a 30 sesiones dependiendo, de la intensidad utilizada, el cuidado al guardarlo y el tipo de piel del cliente.

Cuánto duran las baterías?

Las baterías recargables duran aproximadamente 15 a 20 sesiones de 30 minutos por carga. La batería tiene una vida útil aproximada de 2 años.
Todos los demás productos usan 3 baterías AAA – que duran aproximadamente 40-50 sesiones de 30 minutos.

Con que frecuencia debo usar los productos para ver resultados?

30 minutos al día por 4-5 días a la semana para obtener músculos mas firmes y fuertes en solamente 4-8 semanas.

Preguntas frecuentes

De que esta hecho mi cinturón Slendertone?

El material del cinturón esta hecho de nylon.

Puedo lavar mi cinturón Slendertone ?

Tu cinturón puede ser lavado a mano con agua tibia. Recuerda remover todos los componentes electrónicos y GelPads y mantén los conectores eléctricos secos. Deja que seque naturalmente. No lave el control o baterías.

Prolongación División del Norte No. 5079 Col. San Lorenzo la Cebada C.P. 16035 Del. Xochimilco Mexico, D.F.
Tels: 56 84 24 12/56 84 28 25/ 56 84 26 82 www.industriassanasana.mx www.industriassanasana.net